


3-2. 電源の点検

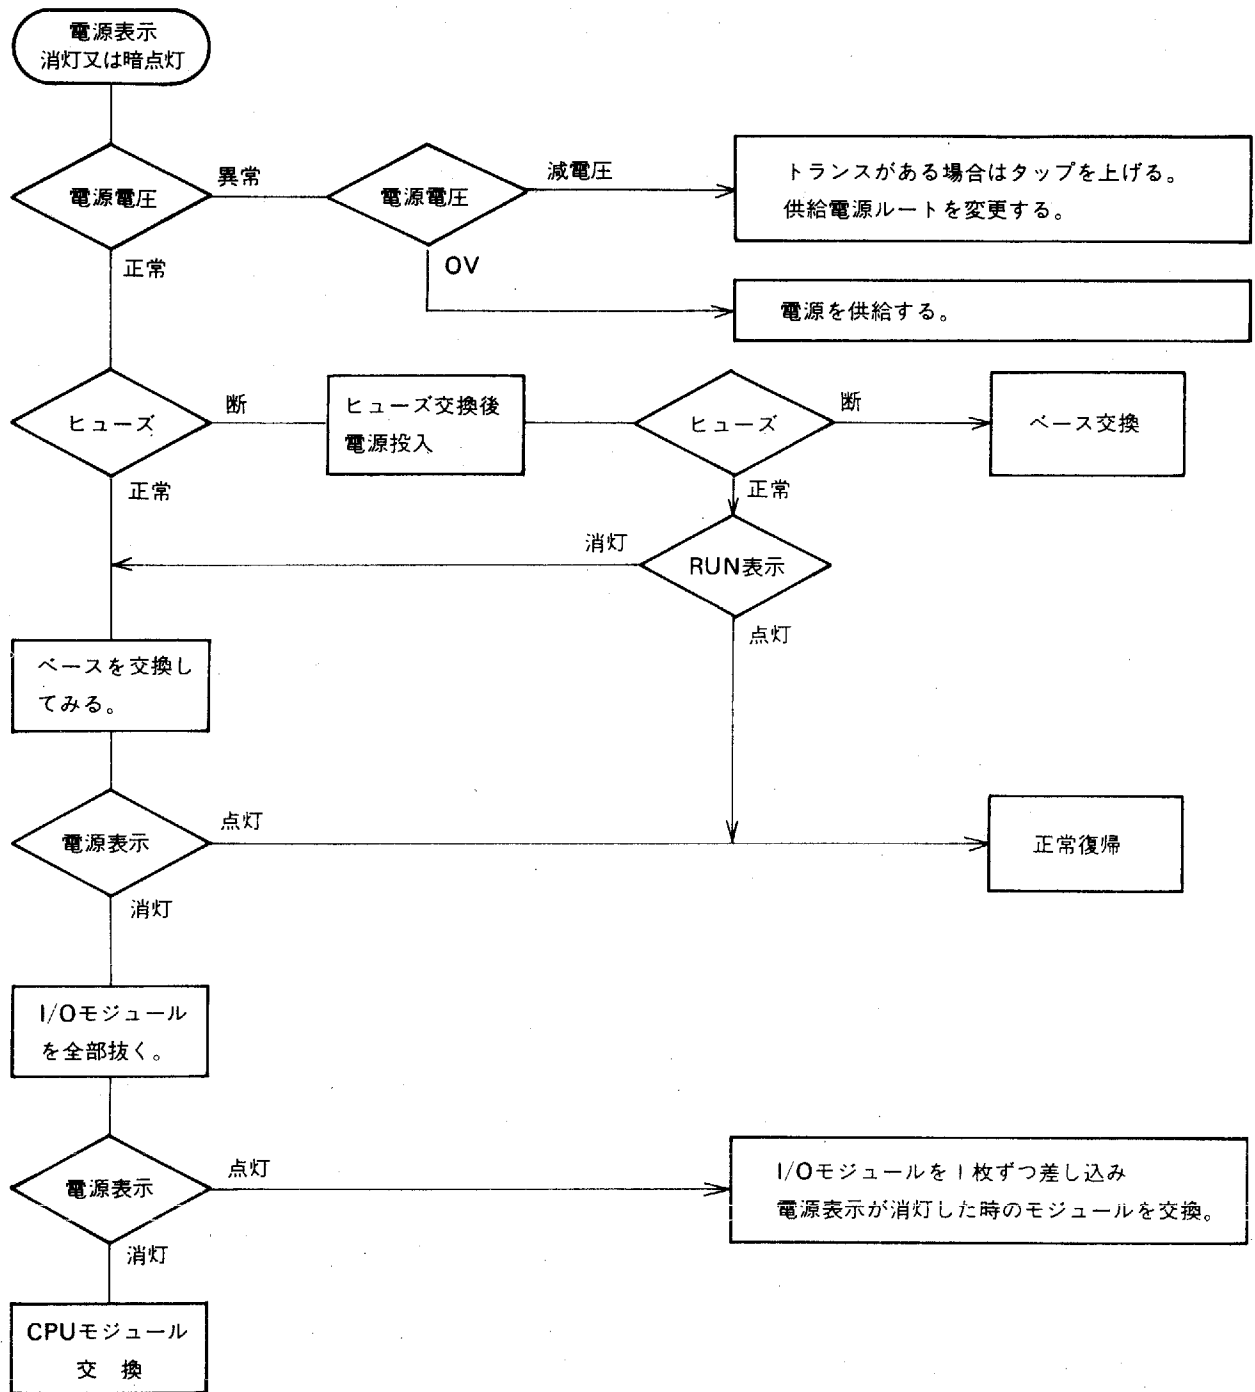

ヒューズ交換方法

右図に示すビスA及びBをはずすとカバーが外れます。

ヒューズはカバーの下に点線で示した位置に1本又は2本（ベース形番により異なる）付いています。交換ヒューズは附属のもの又は同形番のものをご使用下さい。

